




De plus amples informations et d'autres langues sont disponibles à l'adresse suivante

[www.metasystems-probes.com](http://www.metasystems-probes.com)

Courriel: [info@metasystems-probes.com](mailto:info@metasystems-probes.com)

Produit	Marquage	Numéro de référence	UDI-DI	Conditionnement
XL MYC BA triple-color	vert/orange/bleu	D-6030-100-TC	04251315812994	100 µl

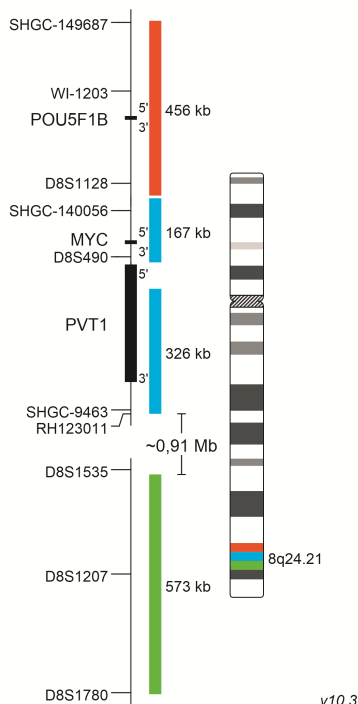

## Utilisation prévue

La sonde XL MYC BA triple-color break-apart est un test qualitatif non automatisé pour la détection des réarrangements *MYC* en 8q24.21 par hybridation in situ en fluorescence (FISH). La conception de la sonde permet également de différencier l'emplacement du point de rupture. Le produit est conçu comme une aide au diagnostic et au suivi de la maladie. La population testée se compose de patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC), de myélome multiple (MM) et de lymphomes non hodgkiniens (LNH), confirmés ou suspectés. L'hybridation doit être réalisée sur des cellules fixées au méthanol/acide acétique dérivées de la moelle osseuse ou du sang périphérique pour la LLC, sur des cellules plasmatiques fixées au méthanol/acide acétique pour le MM et sur des sections de tissus tumoraux fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE) ou sur des cellules fixées au méthanol/acide acétique dérivées du ganglion lymphatique impliqué, de la moelle osseuse impliquée ou d'un autre tissu impliqué pour le LNH.

## Description du produit

La sonde break-apart XL MYC BA triple-color se compose d'une sonde marquée à l'orange s'hybridant proximale de la région du gène *MYC* en 8q24.21, d'une sonde marquée à l'aqua s'hybridant à la région du gène *MYC* en 8q24.21 et d'une sonde marquée au vert s'hybridant distale de la région du gène *MYC* en 8q24.21.

## Réactivité croisée connue

Pas d'hybridation croisée connue

## Matériel fourni

100 µl (10 tests) de XL MYC BA triple-color, la sonde est dissoute dans une solution d'hybridation (> 50 % v/v formamide, < 30 % w/v dextran sulfate et < 2x SSC (saline-citrate de sodium)) et prête à l'emploi.

## Limites

L'analyse, l'interprétation des données et la communication des résultats diagnostiques obtenus par FISH doivent être effectuées conformément aux normes professionnelles et aux lignes directrices pertinentes par un personnel qualifié et expérimenté. Le produit n'est pas destiné à être utilisé comme diagnostic autonome, pour le dépistage d'une maladie ou comme diagnostic complémentaire. Une investigation diagnostique obtenue par ce produit est donc toujours effectuée en conjonction avec d'autres méthodes diagnostiques. Tout écart par rapport aux protocoles du fabricant peut affecter la robustesse et les performances du test et entraîner des résultats trompeurs. Les cartes des sondes sont créées conformément à l'utilisation prévue du produit. Les barres colorées pleines ne signifient pas nécessairement que la sonde couvre entièrement la région génomique indiquée. Seules les lacunes supérieures à 10 kb sont indiquées. Il convient donc d'être prudent lors de l'interprétation des résultats obtenus dans le cadre d'une utilisation non conforme à l'étiquetage. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

En tant que fabricant et distributeur de DIV basé en Allemagne, MetaSystems Probes respecte les réglementations européennes et allemandes en vigueur, qui interdisent toute déclaration concernant l'interprétation des données relatives au patient, ainsi que les recommandations diagnostiques et thérapeutiques, respectivement.

## Stockage et manipulation

Les sondes doivent être conservées à l'abri de la lumière à -20 °C (±5 °C). Il a été démontré que les performances des sondes n'étaient pas affectées pendant 20 cycles de congélation-décongélation. Les sondes étant sensibles à la lumière, l'exposition à la lumière doit être limitée au minimum pendant la manipulation.

## Expédition

Les produits fabriqués par MetaSystems Probes sont expédiés à température ambiante.

## Équipements et matériels nécessaires mais non fournis

- Bain-marie avec contrôle précis de la température
- Plaque chauffante, avec plaque solide et contrôle précis de la température
- Micropipettes de 1 µl à 1 ml, calibrées
- pH-mètre, calibré
- Congélateur -20 °C (±5 °C)
- Chambre humidifiée 37 °C (± 1 °C)
- Microscope à fluorescence avec filtres appropriés (voir ci-dessous)
- Huile d'immersion, recommandée par le fabricant du microscope (qualité fluorescente)
- Thermomètre
- DAPI/antifade
- Rubber cement
- Lames de microscope
- Lamelle (verre):  
22 mm x 22 mm et  
24 mm x 32 mm
- Gants
- Jarre de Coplin
- Pince
- 20x SSC
- Tween-20
- Eau distillée
- Microcentrifugeuse
- Minuterie

## Spécification du fluorochrome

Marquage	Excitation max.	Emission max.
Bleu (aqua)	426 nm	480 nm
Vert	505 nm	530 nm
Orange	552 nm	576 nm

## Recommandation concernant le microscope à fluorescence

- Illumination par fluorescence: Systèmes d'éclairage de fluorescence aux halogénures métalliques ou à LED appropriés ou illuminateurs conventionnels à lampe à mercure de 100 watts.
- Objectifs adaptés à l'éclairage épifluorescent.
- Filtres de fluorescence: Pour la visualisation/le comptage, utilisez un ensemble de filtres passe-bande multiple approprié. Pour la capture d'images ou l'observation de canaux de couleur individuels au microscope, utilisez des jeux de filtres passe-bande unique appropriés pour les fluorochromes respectifs (par exemple, de MetaSystems).

## Principe du test

L'hybridation in situ par fluorescence (FISH) utilise des fragments d'ADN dans lesquels des nucléotides couplés à des fluorophores sont incorporés pour détecter des séquences d'ADN complémentaires dans des cellules fixées sous un microscope à fluorescence. L'ADN des sondes sélectionnées et l'ADN du patient sont dénaturés, ce qui signifie que les deux brins d'ADN de la double hélice sont séparés. Lors de la renaturation ultérieure, les sondes ADN s'hybrident avec les séquences complémentaires de l'ADN du patient.

## Préparation de l'échantillon

### Commentaires généraux

Le produit est conçu pour une utilisation conforme à l'usage prévu. Toutes les méthodes de préparation indiquées ne sont pas nécessairement pertinentes pour le produit. Les suspensions cellulaires sont préparées à partir de cultures à court terme non stimulées d'aspirats de moelle osseuse, de sang total ou de cellules individuelles libérées des ganglions lymphatiques impliqués après un hachage minutieux du tissu ganglionnaire. Pour le myélome multiple, il est recommandé d'enrichir les plasmocytes CD138+ (par exemple, par tri cellulaire magnétique) ou de les identifier in situ à l'aide d'un anticorps approprié marqué par fluorescence (clg-FISH). La préparation des cellules est généralement effectuée selon des protocoles dédiés à l'analyse cytogénétique, comprenant l'arrêt mitotique, le traitement hypotonique et la fixation à l'acide méthanol-acétique. Les suspensions cellulaires ainsi fixées sont déposées sur des lames de verre propres avant l'hybridation. Les échantillons doivent être préparés conformément aux normes des procédures cytogénétiques (par exemple, The AGT Cytogenetics Laboratory Manual, 4e édition, pour les lymphomes, voir également Campbell et al (2015) Pathology 37:493-507 et Ross (2004) Curr Diagn Pathol 10:345-350, pour l'enrichissement en cellules CD138+, voir également Cumova et al (2010) Int J Hematol 92:314-319 et pour la clg-FISH, voir également Gole et al (2012) Blood 120:4792). Les échantillons de tissus fixés au formol et inclus dans la paraffine (FFPE) doivent être déparaffinés et les protéines éliminées pour rendre le noyau accessible à l'hybridation. Après la déparaffinisation au xylène, les réticulations induites par le formol sont réduites par un traitement à l'acide citrique, préparant ainsi la structure à un traitement à la protéinase pour permettre à la sonde de pénétrer dans le noyau. Des

détails supplémentaires sur la procédure standard peuvent être trouvés dans les manuels de laboratoire et les publications (par exemple, The AGT Cytogenetics Laboratory Manual, 4th Edition et Chrzanowska et al (2020) Molecules 25:1864).

## Stabilité des lames hybridées

- Les lames de FISH hybridées peuvent être analysées pendant au moins six mois si elles sont conservées dans l'obscurité à -20 °C (±5 °C).

## Recommandations supplémentaires concernant le processus

- L'utilisation d'un thermomètre calibré est fortement recommandée pour mesurer la température des solutions, des bains-marie et des incubateurs, car ces températures sont essentielles pour une performance optimale du produit.
- Vérifier soigneusement la température des solutions préchauffées.
- Vérifiez soigneusement la valeur du pH de toutes les solutions. Elle doit être comprise entre 7,0 et 7,5 à température ambiante.
- Les concentrations des tampons (stringence), le pH et la température sont importants car une stringence insuffisante peut entraîner une liaison non spécifique de la sonde et une stringence trop élevée peut entraîner une réduction de l'intensité du signal ou une disparition des signaux.
- Avant l'ouverture: vortexer brièvement pour recueillir la sonde au fond du tube.

## Protocole FISH pour les sondes ADN de MetaSystems

### Préparation des lames

- Déposer l'échantillon cellulaire sur une lame de microscope. Laisser sécher à l'air. Si les lames ne sont pas utilisées dans les prochains jours, les conserver à -20 °C (±5 °C).
- Appliquer 10 µl de sonde.
- Couvrir avec une lamelle de 22 mm x 22 mm.
- Sceller à l'aide d'une colle en caoutchouc.

### Dénaturation

- Dénaturer simultanément l'échantillon et la sonde en chauffant la lame sur une plaque chauffante à 75 °C (±1 °C) pendant 2 minutes.  
Pour les coupes de tissus, des temps et des températures de dénaturation différents peuvent s'appliquer. Veuillez vous référer au kit de prétraitement des tissus de MetaSystems, D-0905-025-TF.

### Hybridation

- Incuber dans une chambre humidifiée à 37 °C (±1 °C) pendant la nuit.

### Lavages Post-hybridation

#### Solutions requises

- 0,4x SSC (pH 7,0 - 7,5) à 72 °C (±1 °C)
- 2x SSC, 0,05 % Tween-20 (pH 7,0) à température ambiante

#### Procédure

- Retirer soigneusement la lamelle couvre-objet et toute trace de colle.
- Laver la lame dans 0,4x SSC (pH 7,0) à 72 °C (±1 °C) pendant 2 minutes.
- Egoutter la lame et la laver dans 2x SSC, 0,05 % Tween-20 (pH 7,0) à température ambiante pendant 30 secondes.
- Rincer brièvement à l'eau distillée pour éviter la formation de cristaux et laisser sécher à l'air.

### Contre-colorant

#### Solutions requises:

- DAPI/antifade (par exemple, MetaSystems Probes DAPI/antifade, D-0902-500-DA)

#### Procédure:

- Appliquer 10 µl de DAPI/antifade et recouvrir d'une lamelle couvre-objet de 24 mm x 32 mm.
- Laisser pénétrer le DAPI/antifade pendant 10 minutes.
- Procéder à la microscopie et à l'analyse.
- Conservé les lames à -20 °C (±5 °C).

## Résultats attendus

Seules les signaux les plus fréquentes sont représentées, d'autres modèles de signaux pertinents peuvent être observés.

Cellule normale:

Deux signaux de colocalisation/fusion vert-orange-bleu (2GOB).



Cellule anormale (résultats typiques):

Un signal de colocalisation/fusion vert-orange-bleu (1GOB), un signal de colocalisation/fusion vert-bleu (1GB) et un signal orange séparé (1O) résultant d'une cassure chromosomique dans le locus concerné.



Cellule anormale (résultats typiques):

Un signal de colocalisation/fusion vert-orange-bleu (1GOB), un signal séparé vert (1G) et un signal de colocalisation/fusion orange-bleu (1OB) résultant d'une cassure chromosomique dans le locus concerné.



Cellule anormale (résultats typiques):

Un signal de colocalisation/fusion vert-orange-bleu (1GOB), un signal de colocalisation/fusion vert-bleu (1GB) et un signal de colocalisation/fusion orange-bleu (1OB) résultant d'une cassure chromosomique dans le locus concerné.



## Performance analytique

Les données de performance analytique ont été recueillies à partir de noyaux en interphase provenant de cultures de lymphocytes stimulées par la PHA. Le prélèvement des cellules a été effectué conformément aux normes cytogénétiques. L'équivalence des résultats entre les cultures de moelle osseuse non stimulées et les lymphocytes stimulés par la PHA a été assurée par une étude comparative.

### Spécificité analytique

La spécificité est calculée comme le pourcentage de cibles correctes détectées par rapport au nombre total de cibles détectées.

La spécificité analytique calculée est de 100 % après 20 métaphases évaluées provenant de 5 hommes différents de caryotypes normaux.

### Sensibilité analytique

La sensibilité analytique est calculée comme le pourcentage de noyaux interphasiques qui ont le profil de signal normal attendu sur le nombre total de noyaux interphasiques analysés. Le signal de 400 noyaux provenant de 10 individus de caryotypes normaux a été analysé.

Le degré d'écart par rapport à la moyenne est représenté par l'écart-type relatif (% RSD).

Pattern	Sensibilité	% RSD
2 GOB (normal)	99.3 %	0.6%

### Seuil (Cut-off)

Le seuil d'un test qualitatif est le seuil au-dessus duquel le résultat est considéré comme positif et au-dessous duquel le résultat est considéré comme négatif.

La valeur seuil a été calculée sur la base d'hybridations de sondes sur des noyaux en interphase de 10 individus de caryotypes normaux. Les valeurs seuils sont basées sur 400 noyaux notés chacun.

Pattern	Cut-Off
1GOB 1GB 1O	0.8 %
1GOB 1G 1OB	3.3 %
1GOB 1GB 1OB	1.9 %

La valeur seuil est informative et dépend de plusieurs paramètres liés au laboratoire. Par conséquent, pour une utilisation diagnostique, les valeurs seuils doivent être déterminées individuellement par chaque laboratoire.

### Précision (reproductibilité/ répétabilité)

La reproductibilité est le degré de concordance entre les résultats des études de sensibilité analytique réalisées dans des conditions

différentes (jour, lot et échantillon). Pour chaque condition, trois analyses ont été effectuées avec 100 noyaux chacune.

La reproductibilité est donnée par le degré de déviation de la moyenne par l'écart-type relatif (% RSD).

Conditions	Reproductibilité % RSD
Jour après jour même lot et même individu pendant trois jours	0.6 %
Lot-à-lot même personne et même jour avec trois lots	0.6 %
Échantillon à échantillon même lot et même jour avec trois individus	0.0 %

La répétabilité est le degré de concordance entre les études réalisées dans les mêmes conditions. Des études de répétabilité distinctes n'ont pas été réalisées, car le degré d'écart par rapport à la moyenne dans les études de reproductibilité réalisées dans des conditions différentes a été déterminé avec un écart-type relatif de  $\leq 5$  % (% RSD). Par conséquent, un degré d'écart par rapport à la moyenne dans des conditions égales avec  $\leq 5$  % d'écart-type relatif (% RSD) a été conclu.

## Performance clinique

### Littérature publiée

Les allégations de performance clinique du produit par rapport à l'objectif visé ont été étayées par la littérature scientifique relative au produit et à l'affection analysée avec le produit.

- Gonzalez-Farre et al (2019) Haematologica 104:1822-1829
- Demyanets et al (2020) Ann Hematol. 99:2599-2609
- Collinge et al (2021) Blood 137:2196-2208
- Mokánszki et al (2021) Cancers 13:3032
- Sandmann et al (2022) Front Oncol 12:919278

### Publication de l'expérience acquise grâce aux tests de diagnostic de routine

Les données des tests de diagnostic de routine ont été obtenues auprès de laboratoires de diagnostic européens et publiées sur le site web de MetaSystems Probes (voir la fiche de performance correspondante dans la section de téléchargement correspondant à ce produit spécifique). La présence du marqueur cible dans les cas positifs et son absence dans les cas négatifs détectés par FISH ont été confirmées par des technologies de référence (analyse des bandes chromosomiques). La cohorte de test comprend des patients atteints de LLA, LMA, LLC, LMC/NMP, SMD, MM et LNH, confirmés ou suspects. Les échantillons ont été prélevés dans la moelle osseuse et le sang périphérique.

Réarrangement	Nombre de cas		Sensibilité diagnostique	Spécificité diagnostique
Réarrangements MYC en 8q24.21*	D-6023	427	100 %	99.9 %**
	D-6030	1524		
	Σ	1951		

\*La composition et la conception de la sonde concernant les parties verte et orange de la sonde D-6030 sont identiques à celles de la sonde D-6023, XL MYC BA, et permettent donc de détecter des cassures dans la région du gène MYC de manière exactement similaire. La similitude entre ces deux sondes nous permet de combiner les données issues de l'expérience acquise lors des tests diagnostiques de routine réalisés avec les sondes D-6023 et D-6030.

\*\* Deux cas utilisant XL MYC BA triple couleur ont montré une séparation net dans les sondes marquées en bleu, et les résultats n'ont pas pu être confirmés par la cytogénétique. Ces deux cas ont été considérés comme des faux positifs pour la FISH, bien que l'on ne sache pas exactement laquelle des deux technologies a généré le faux résultat dans ces cas.

La différenciation des points de cassure a été évaluée sur 20 cas positifs en accordant une attention particulière au signal bleu. Les modèles aberrants suivants ont été observés: 1OB1GB, 1OB1G, 2OB, 1O1GB. Les combinaisons de couleurs observées dans ces motifs de signal aberrants permettent, dans les limites de la résolution de la technologie FISH, de conclure à la localisation du point de cassure sur le chromosome 8.

### Autres sources de données sur les performances cliniques




L'évaluation des données de validation diagnostique collectées dans le cadre de la DDIV et classées comme autres sources de données de performance clinique montre que XL MYC BA triple-color a correctement identifié les 11 cas aberrants analysés.

## Procédure de contrôle de la qualité

Avant l'utilisation initiale de ce produit dans le domaine du diagnostic, il convient de vérifier qu'il fonctionne comme prévu. Il convient de tenir compte des orientations et des recommandations relatives à la mise en œuvre de nouveaux tests FISH dans le domaine du diagnostic (par exemple, CLSI Fluorescence In Situ Hybridization Methods for Clinical Laboratories ; Approved Guideline - Second Edition).

## Consignes de sécurité

Toutes les sondes produites par MetaSystems Probes sont destinées à un usage professionnel uniquement et doivent être utilisées par un personnel qualifié et formé. Pour garantir un fonctionnement sûr et des résultats reproductibles, veuillez respecter les consignes de sécurité et les panneaux d'avertissement ci-dessous.

	<b>DANGER</b>
Contient:	Formamide
Mentions de danger:	H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire à l'enfant à naître. H351 Susceptible de provoquer le cancer. H373 Peut provoquer des lésions aux organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Conseils de prudence:	P201 Obtenir des instructions spéciales avant l'utilisation. P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection. P308+ P313 EN CAS d'exposition ou d'inquiétude: Consulter un médecin. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.
Étiquetage spécial:	Réservé aux utilisateurs professionnels.
	<b>ATTENTION: Bain d'eau chaude et plaques chauffantes !</b> Pour la dénaturation et l'hybridation, des bains d'eau chaude et des plaques chauffantes sont utilisés à des températures supérieures à 37°C. Veuillez à ne pas entrer en contact direct avec des surfaces ou des liquides chauds. Porter des gants et une blouse de laboratoire. En cas de contact avec la peau, refroidir immédiatement à
	<b>ATTENTION: Bonnes pratiques de laboratoire !</b> Utiliser conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire.

## Rapport sur les événements indésirables

Tout incident grave lié au dispositif est signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

### Dépannage

Problème	Cause(s) potentielle(s)	Solution recommandée
Aucun signal FISH n'est détecté au microscope.	• Lumière réfléchi obturateur fermé / curseur d'arrêt dans le trajet de la lumière.	• Ouvrez l'obturateur / déplacez le curseur d'arrêt hors de la trajectoire de la lumière.
	• La lampe fluorescente est éteinte.	• Allumer la lampe fluorescente.
	• Le mauvais filtre de fluorescence se trouve sur le trajet de la lumière.	• Placer le filtre correct dans le trajet optique.
	• L'objectif n'est pas en position.	• Basculer l'objectif dans la trajectoire de la lumière.
	• Le phototube est en position de caméra.	• Trajet lumineux direct vers les oculaires.
Les signaux d'hybridation deviennent faibles après un certain temps.	• L'huile d'immersion a pénétré entre la lame de verre et la lamelle.	• Remplacer la lamelle et le DAPI/antifade. Utiliser une lamelle 24 mm x 32 mm même si seule une petite région est hybridée.
Signaux diffus.	• La préparation n'est pas suffisamment éclairée.	• Vérifier le trajet optique du microscope. Régler correctement la lumière UV. Vérifier la durée de vie de la lampe UV.
	• Le plan de mise au point ne peut pas être réglé correctement.	• Utiliser suffisamment d'huile d'immersion. Ne pas mélanger différentes huiles d'immersion. Utiliser une huile d'immersion adaptée à la fluorescence. • La couche d'antifade est trop épaisse pour permettre la mise au point. Ne pas utiliser trop de DAPI/antifade. 10 µl par lame (24 mm x 32 mm) sont suffisants. • Utiliser des lamelles couvre-objet appropriées.
Signaux faibles.	• La préparation des lames est trop ancienne.	• Les lames ne doivent pas dater de plus de deux semaines. Si les lames ne sont pas utilisées pendant cette période, elles doivent être conservées à -20 °C (±5 °C).
	• La dénaturation n'est pas suffisante.	• Le vieillissement, la cuisson ou une fixation supplémentaire peuvent inhiber l'hybridation et ne sont pas recommandés. • Augmenter la température de dénaturation jusqu'à 80 °C ou augmenter la durée de dénaturation jusqu'à 3 min.
	• Un filtre passe-bande multiple est utilisé pour la visualisation.	• Utiliser un filtre passe-bande unique dédié.
Faibles signaux aqua ou verts ou arrière-plan très diffus dans le canal de couleur vert.	• L'intensité du DAPI est trop élevée, ce qui entraîne un cross-talk avec le filtre AQUA ou le filtre VERT.	• Utiliser du DAPI/antifade à faible concentration.
	• Le pH des solutions de lavage est trop faible.	• Veiller à ce que le pH des solutions soit compris entre 7,0 et 7,5. Certains fluorophores verts sont très sensibles à un pH inférieur à 7.
Fond non spécifique élevé.	• Les protéines cytoplasmiques restantes des cellules peuvent nuire à l'hybridation.	• Prétraiter les lames avec de la pepsine.
Si les mesures recommandées ne résolvent pas le problème, ou si votre problème n'est pas répertorié, veuillez contacter MetaSystems Probes.		

### Support à la clientèle

Veuillez contacter MetaSystems Probes GmbH (coordonnées ci-dessous).



MetaSystems Probes GmbH  
1. Industriestrasse 7  
68804 Altlussheim  
Allemagne

Tél.: +49 (0)6205 292760  
Fax: +49 (0)6205 2927629  
Courriel: [info@metasystems-probes.com](mailto:info@metasystems-probes.com)  
Site web: [www.metasystems-probes.com](http://www.metasystems-probes.com)

MetaSystems Probes décline tout droit de propriété sur les marques et les noms d'autrui.

Pour un *résumé de la sécurité et de la performance*, visitez le site web <https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home> ou renseignez-vous à l'adresse [info@metasystems-probes.com](mailto:info@metasystems-probes.com).

### Symboles utilisés

Symbole	Description
	Indique un <i>dispositif médical</i> destiné à être utilisé comme <i>dispositif médical de diagnostic in vitro</i> .
	Marque de conformité qui indique qu'un appareil est conforme aux exigences réglementaires applicables dans l'Union européenne.
	Indique le <i>fabricant du dispositif médical</i> .
	Indique qu'il faut être prudent lors de l'utilisation du dispositif ou de la commande à proximité de l'endroit où le symbole est placé, ou que la situation actuelle nécessite une prise de conscience ou une action de la part de l'opérateur afin d'éviter des conséquences indésirables.
	Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le <i>mode d'emploi</i> .

## Révision du document

Révision	Date d'émission	Indication de changement
FR-CE-IVD-RevA250203-250203v10.3	06.02.2025	Mise à jour de l'IFU conformément au RÈGLEMENT (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. La mise à jour n'affecte pas directement les caractéristiques des dispositifs et n'a pas d'impact sur la composition ou les ingrédients de nos produits. Elle n'influence pas non plus la manière dont nos produits sont appliqués, mais déclenche des changements dans les informations fournies avec le produit comme les étiquettes, la destination et les instructions d'utilisation.